

A FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 285984/2025 EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 0099/2025 Parecer Técnico nº 020/2025

A empresa VIZAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita sob o nº CNPJ 37.842.193/0001-38, estabelecida na rua Jose Oscar Torezan, 40, Park Empresarial II, na cidade de Iracemápolis/SP, por intermédio de seu representante supra assinado abaixo, **PASSA A RESPONDER A DILIGÊNCIA**, conforme duvidas suscitadas.

Avaliação técnica da Engenharia FHGV: SOLICITA ESCLARECIMENTOS.
Em análise à documentação apresentada referente à Termodesinfectora SOTER TS-300, verificamos que o catálogo menciona apenas “ventilação forçada de ar dentro da câmara de lavagem”, sem detalhar se o equipamento possui sistema de secagem com turbina de circulação de ar quente filtrado, conforme exigido pelo edital de licitação. Na diligência enviada pela empresa, não foi apresentada qualquer evidência técnica que comprove o atendimento a esse item. Diante disso, solicitamos que seja fornecida comprovação técnica de que o equipamento atende integralmente a este requisito, incluindo, se possível, esquemas, fotos, relatórios ou certificados que demonstrem a presença da turbina de secagem com circulação de ar quente filtrado, bem como informações detalhadas do sistema de secagem no manual técnico.

Resp. O sistema de secagem do nosso equipamento é composto por: voluta, rotor, motor elétrico, resistências elétricas e filtro HEPA.

O ar é movimentado por meio da ação conjunta do rotor, da voluta e do motor elétrico, sendo direcionado para o interior da câmara. Antes de ser insuflado, esse ar é aquecido por resistências elétricas e filtrado por um filtro HEPA, garantindo a pureza necessária ao processo de secagem.

Tecnicamente, esse sistema é funcionalmente equivalente a uma turbina de secagem com circulação de ar quente filtrado, conforme exigido no edital. A movimentação forçada do ar por meio de rotor e voluta caracteriza a ação de uma turbina, e o processo de aquecimento e filtragem assegura as mesmas condições de funcionamento e eficácia descritas na especificação




Motor elétrico



Voluta



Rotor

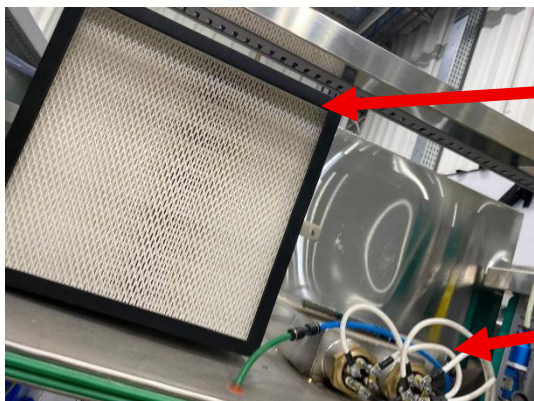

Filtro HEPA H14

Resistências

Reafirmamos o compromisso de fornecer o equipamento conforme solicitado do Edital do Pregão Eletrônico **0099/2025**.

Para mais esclarecimentos, estamos à disposição.

Atenciosamente.

Iracemápolis/SP, 10 de setembro de 2025.

Leandro Luis Zaneti